


Прилад УТФ-70А для проведення температурних випробувань дизельного палива в автоматичному режимі по ГОСТ 22254-92, ГОСТ 22254, EN 116 - ДСТУ EN 116, ASTM D6371, IP 309-IP 419.

УТФ-70А

автоматичний прилад для проведення температурних випробувань

Також є можливість змінювати параметри температура початкової аспірації, шаг пониження температури

Прилад УТФ-70А чітко контролює охолодження проби і автоматично регулювання подачу вакууму

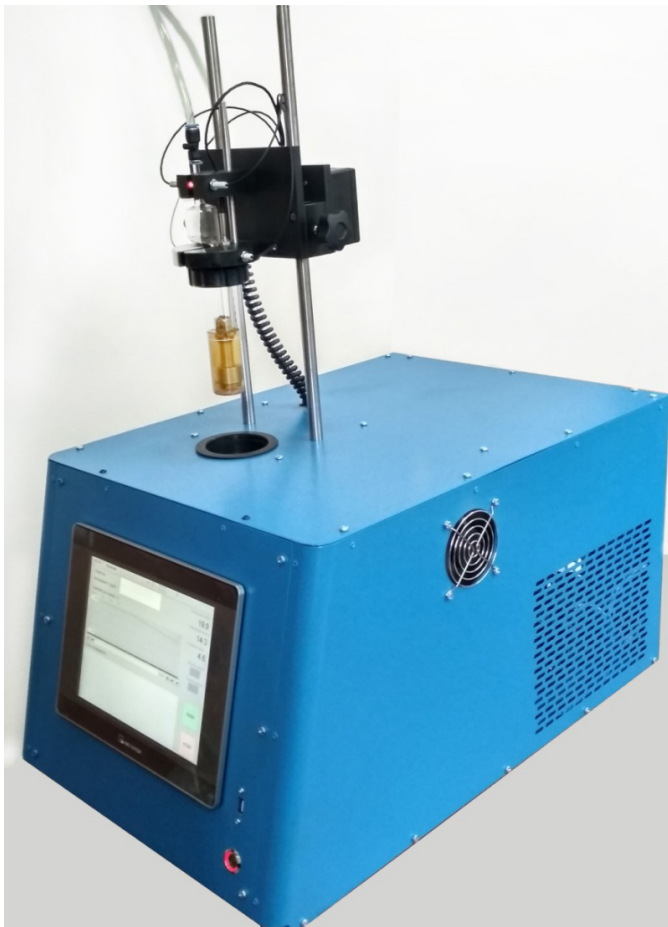

Використання та впровадження УТФ-70А дозволяє:

- Отримувати точні та надійні результати випробувань;
- Максимально швидко оброблювати данні
- Організувати стабільну та якісну роботу випробувань, так як прилад оснащений вбудованою системою само тестування
- Проводити стандартні випробування та задані користувачем
- Проводити випробування на ультра низьких температурах
- Ретельно документувати всі параметри та результати будь якого випробування
- Зберігання та підготовлювати для друку стандартні протоколи (звіти), які включають в себе ідентифікатор проби, дату ,час, ідентифікатор оператора, час граничної температури фільтрувальності, відомості про метод випробування робочі температури процесу випробування.
- Отримувати розширені звіти про всі тестові температури, часові інтервали між циклами аспірації, час аспірації, час що необхідний для досягнення самої високої температури та час що необхідний для повного зливу зразка з піпетки.
- Підвищити ефективність роботи лабораторії
- Підвищити мобільність за рахунок автономної системи охолодження
- Прилад не потребує додаткових кріостатів та охолоджувальних рідин.
- Прилад оснащений та комплектується всім необхідним для роботи та проведення випробувань “ із коробки”.

- При виготовленні використовуються комплектуючі провідних європейських брендів, має європейські можливості та якість за Українську вартість.
- При виготовленні та розробці використовувався більш ніж 15-річний досвід у виготовленні та впровадженні в лабораторіях приладів для різноманітних випробувань палив.
- Надійний та швидкий гарантійний сервіс від Українського виробника.

Основні технічні характеристики УТФ-70А

Характеристика	Од. вим.	Значення
Робочий діапазон температур	°C	+50...-85
Точність підтримування температури		± 0,5

Робоча температура та точність підтримування в робочому об'ємі на іспитах по запрограмован

1. мінус ($34 \pm 0,5$)

2. мінус ($51 \pm 0,5$)

3. мінус ($67 \pm 0,5$)

ература в діапазоні +50...-85°C кроком 0,1°C

В повній відповідності до стандартів випробувань або визначається користувачем.

Охолодження проби

андартних методів випробувань або визначається користувачем:

• ступінчате
• лінійне
• диференціальне

В повній відповідності з вимогами стандартних методів випробувань або визначається користувачем.
В повній відповідності з вимогами стандартних методів випробувань або визначається користувачем.
В повній відповідності з вимогами стандартних методів випробувань або визначається користувачем.
Звіти

ображення на дисплеї вбудованої 19" сенсорної панелі
ення на флеш носії для подальшого друку на ПК

Система охолодження	не потребує додатково підключаємих кріостатів та охолоджувальних рідин	
Живлення установки	від мережі змінного струму напругою 220/50гц	
Споживча потужність	не більше кВт	1,5
Габаритні розміри установки	±10мм.ШхГхВ	425x645x780
Маса установки	кг.	~50
Комплект		

ель живлення, флеш носій, піпетка - 3 шт., пробірка - 3 шт.,
льтра - 10 шт., запобіжник - 1 шт., керівництво з експлуатації.